

检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: VSCN-0245-34


共3页 第1页



No: 200065146

委托单位	[REDACTED]		
客户认定信息	防护口罩 50个 商标: [REDACTED] 规格: KN95/15.0cm*9.5cm		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-04-07
		报告签发日期	2020-04-14
判定依据	GB 2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》		
综合检验结论	—		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006	符合
	吸气阻力	GB 2626-2006	符合
	呼气阻力	GB 2626-2006	符合
	头带	GB 2626-2006	符合
	外观检查[2个]	GB 2626-2006	符合
备注	外观检查项目暂未获得CNAS认可。 本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 胡万丽 工程师





样品图片

(电子版)

No:200065146

共3页 第2页

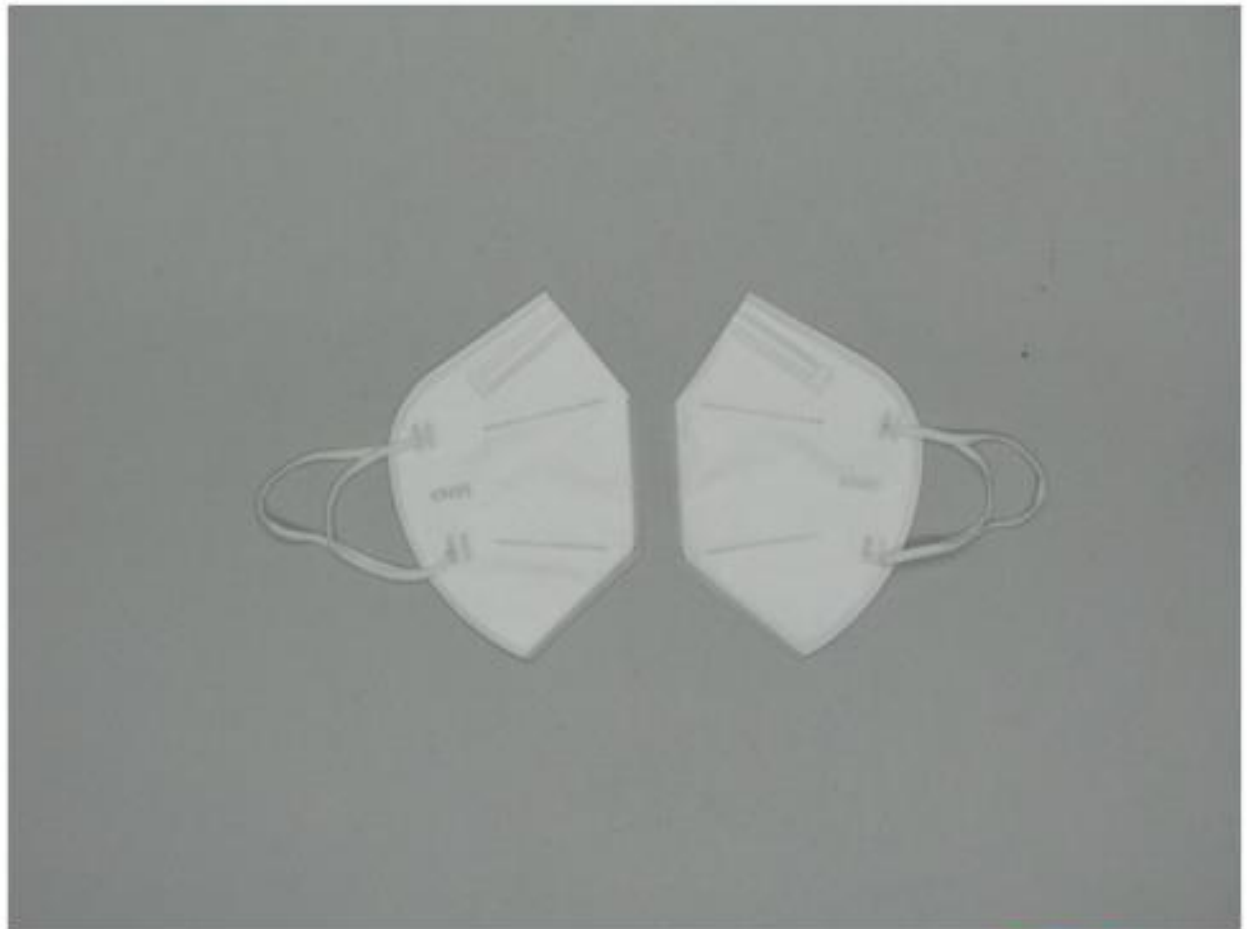

检验检测报告附页 (电子版)

No:200065146

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006 6.3 空气流量:85L/min 气溶胶颗粒:NaCl 气溶胶浓度:15mg/m ³ 温度:23.1℃ 相对湿度:36.0%	过滤效率(%): ≥95.0 (KN95)	过滤效率(%): 未处理样品 1# 99.432 2# 99.416 3# 99.375 4# 99.475 5# 99.480 6# 99.350 7# 99.281 8# 99.316 9# 99.456 10# 99.421 温湿度预处理后样品 1# 99.376 2# 99.214 3# 99.433 4# 98.96 5# 99.145	符合	
●吸气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.5 头模:中号	≤350	未处理样品: 1# 186.6 2# 182.4 预处理样品: 1# 178.6 2# 175.2	符合	
●呼气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.6 头模:中号	≤250	未处理样品: 1# 123.8 2# 126.7 预处理样品: 1# 117.5 2# 113.3	符合	
●头带	GB 2626-2006 6.11	面罩的每条头带,带扣及其他调节部件在承受10N的拉力,持续10s,不应出现滑脱或断裂。	未处理样品: 1# 符合要求 温湿度预处理后样品: 1# 符合要求	符合	
●外观检查[2个]	GB 2626-2006 6.1	按标准5.2条要求	符合要求	符合	
备注	(本栏空白)				



——本报告结束——